


VERIFICATION DU RECAL ANABOLISANT

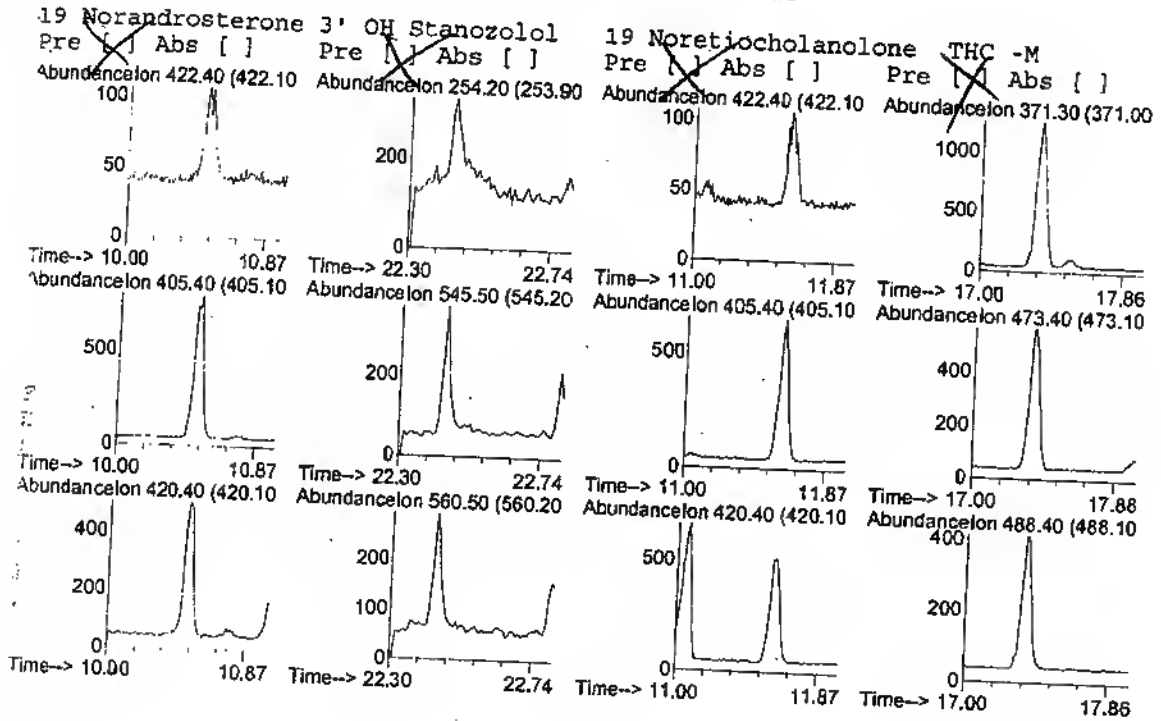

Date : 21.07.06
 Opérateur : 31
 Résultats :
 Conforme
 Non conforme
 Remarques : Avec EA 96